

令和4年度
三重県臨床検査技師会 精度管理報告会

免疫血清部門

「免疫グロブリン」

独立行政法人 桑名市総合医療センター

水谷 直弘

調査項目

〈免疫グロブリン〉

▶ IgG

▶ IgA

▶ IgM

配布試料

- ▶ 化学11：日臨技管理試料
- ▶ 化学12：日臨技管理試料

評価方法

〈免疫グロブリン〉

全施設、全測定試薬の測定値より $\pm 3SD$ を超える値を除外し、求めた平均値を目標値とした。

項目	A評価	B評価	C評価
IgG	5%	10%	15%
IgA	5%	10%	15%
IgM	5%	10%	15%

I g G 検査試薬（機器）別集計

	N 【前年】	化学⑪			化学⑫		
		評価					
		A	B	C	A	B	C
ニットーボーメディカル株式会社	13 【14】	13	0	0	13	0	0
株式会社LSIメディエンス	3	3	0	0	3	0	0
デンカ生研株式会社	1	1	0	0	1	0	0
富士フイルム和光純薬株式会社	4	4	0	0	4	0	0
シーメンスヘルスケア・ダイアグノ スティクス 株式会社（専用機器）	1	1	0	0	1	0	0
計	22	22	0	0	22	0	0

IgG

1100.0

1000.0

化学^⑪

900.0

800.0

1000.0

1100.0

1200.0

1300.0

1400.0

化学^⑫


● シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

● デンカ株式会社

● ニットーボーメディカル株式会社

● 株式会社LSIメディエンス

● 富士フイルム和光純薬株式会社

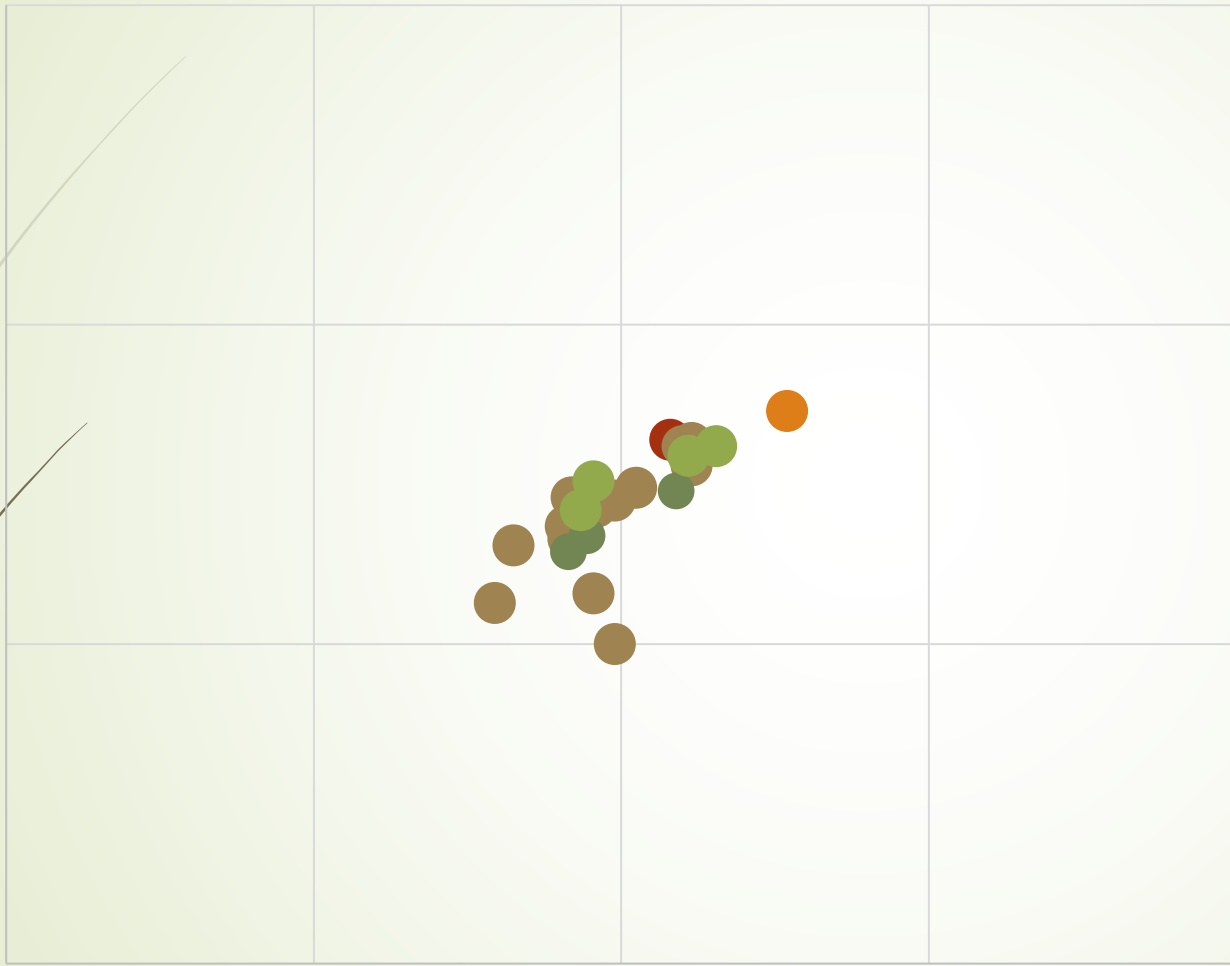

IgA検査試薬（機器）別集計

	N 【前年】	化学⑪			化学⑫		
		評価					
		A	B	C	A	B	C
ニッポーボーメディカル株式会社	12 【13】	12	0	0	12	0	0
株式会社LSIメディエンス	3	3	0	0	3	0	0
デンカ生研株式会社	1	1	0	0	1	0	0
富士フイルム和光純薬株式会社	4	4	0	0	4	0	0
シーメンスヘルスケア・ダイアグノ スティクス株式会社（専用機器）	1	0	1	0	0	0	1
計	21	20	1	0	20	0	1


IgA

化学^⑪

200.0
190.0
180.0
170.0
160.0
150.0

200.0 210.0 220.0 230.0 240.0 250.0
化学^⑫


- シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社
- デンカ株式会社
- ニットーボーメディカル株式会社
- 株式会社LSIメディエンス
- 富士フイルム和光純薬株式会社

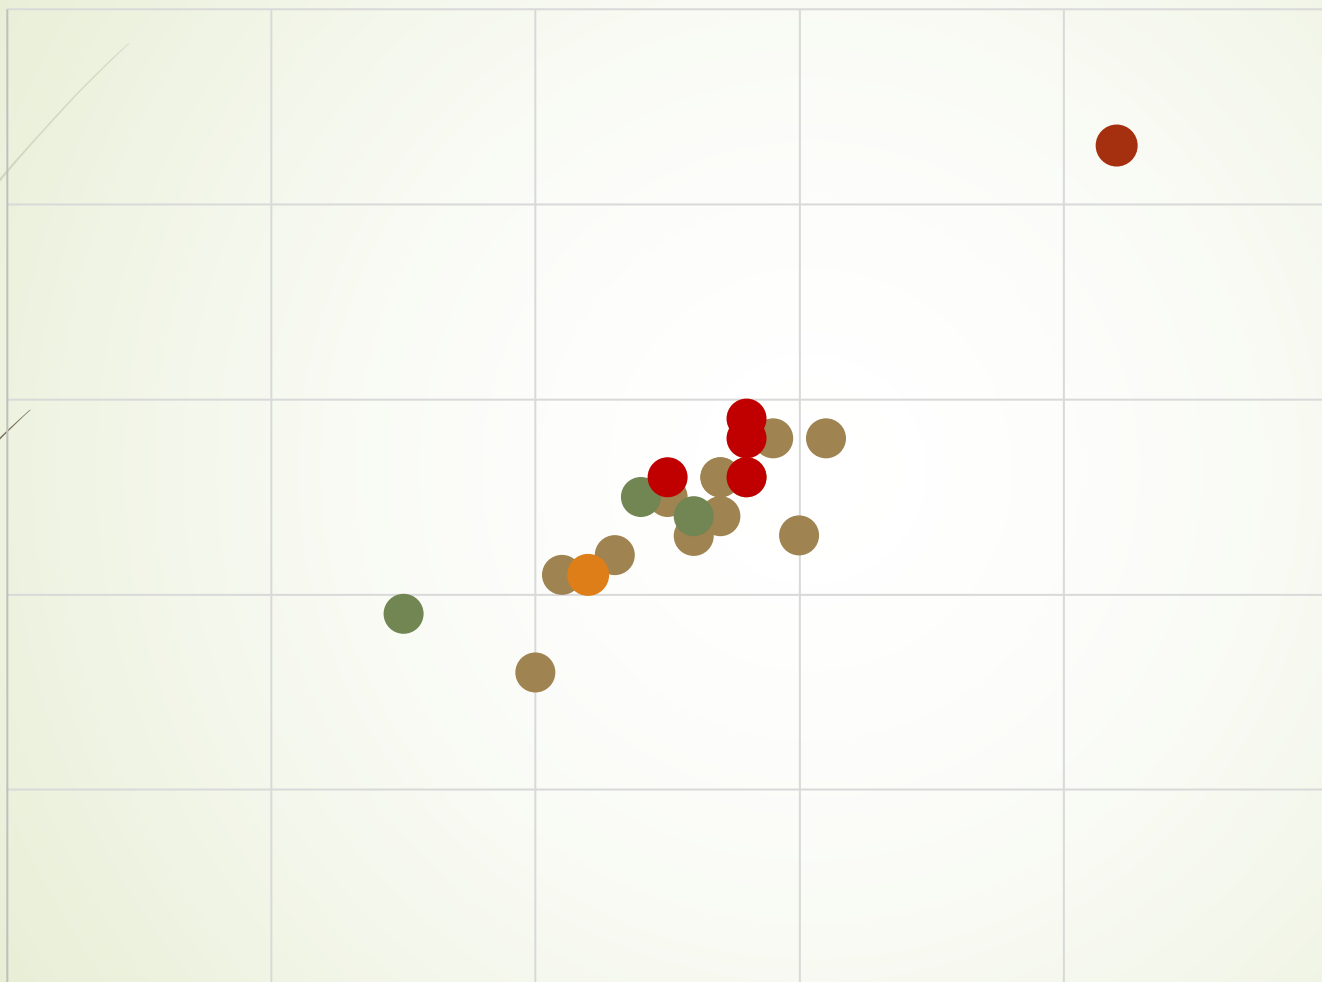

I g M検査試薬（機器）別集計

	N 【前年】	化学⑪			化学⑫		
		評価					
		A	B	C	A	B	C
ニッポーボーメディカル株式会社	13 【14】	13	0	0	12	1	0
株式会社LSIメディエンス	3	3	0	0	3	0	0
デンカ生研株式会社	1	1	0	0	1	0	0
富士フイルム和光純薬株式会社	4	4	0	0	4	0	0
シーメンスヘルスケア・ダイアグノ スティクス株式会社（専用機器）	1	0	1	0	0	1	0
計	22	21	1	0	20	2	0

IgM

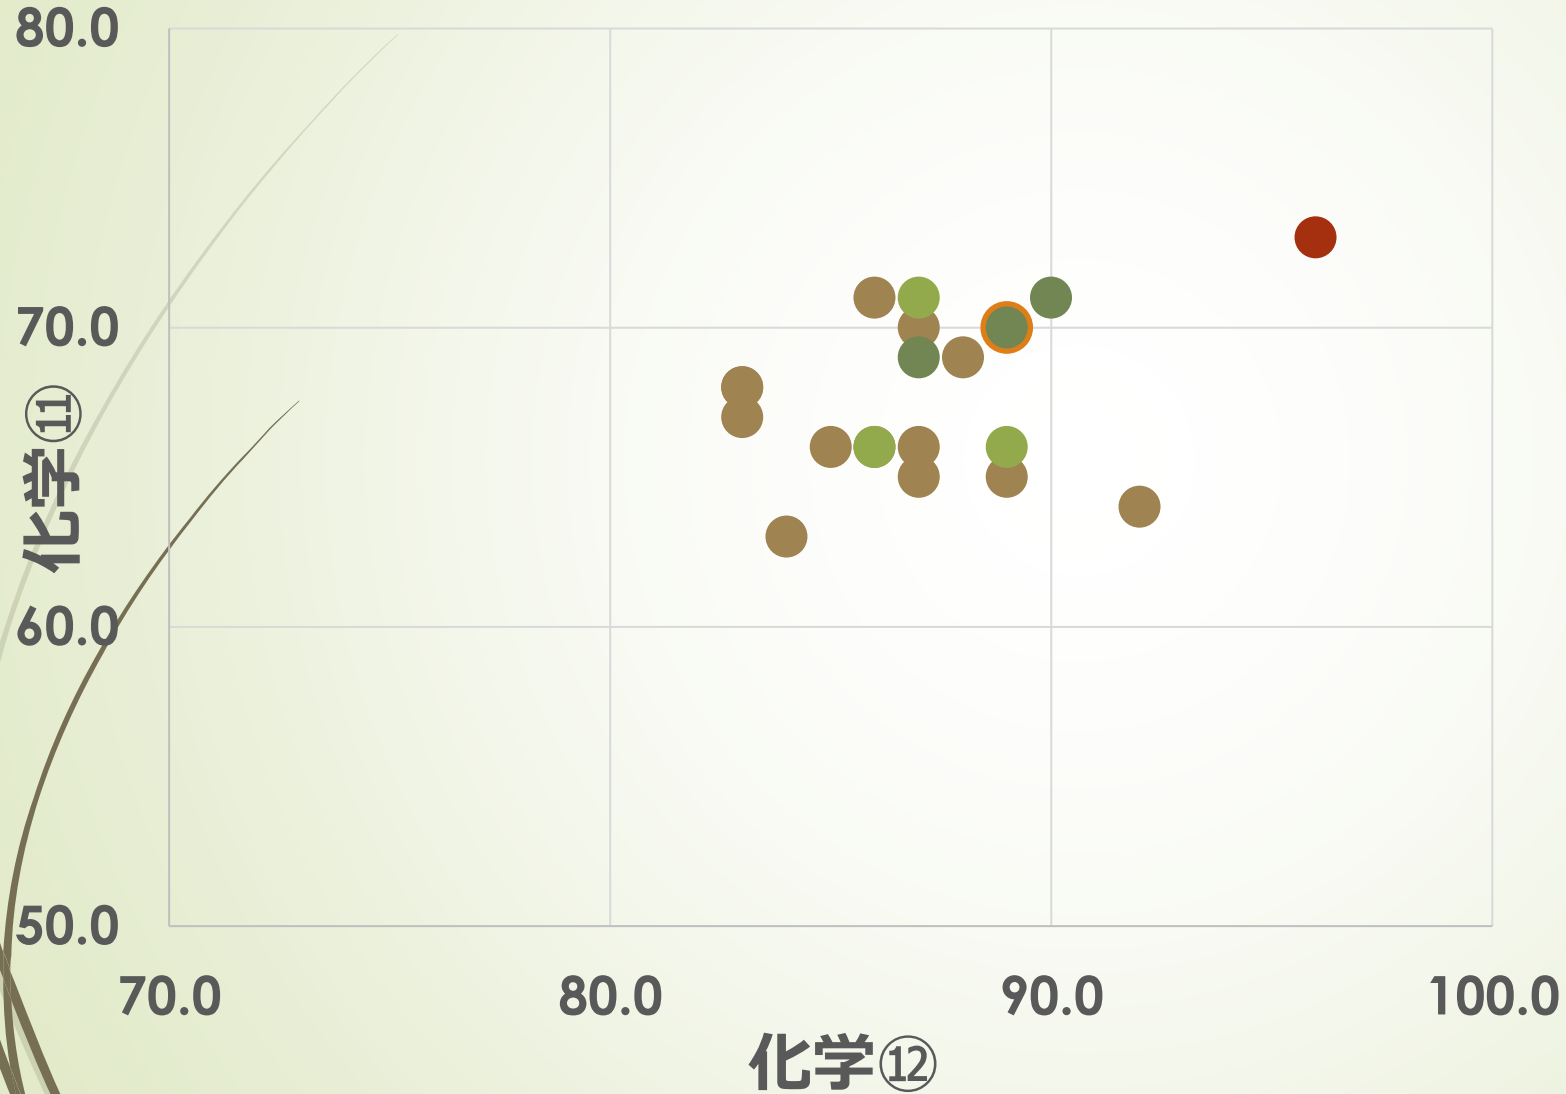

- シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
- デンカ株式会社
- ニットーボーメディカル株式会社
- 株式会社LSIメディエンス
- 富士フイルム和光純薬株式会社

まとめ

- ➡ 一部外れた施設もありましたが、例年通り比較的収束した結果が得られた。
- ➡ 試薬ごとに明らかな傾向は見られなかった

問い合わせ

- 施設名：桑名市総合医療センター
- 担当者名：水谷 直弘
- 電話番号：0594-22-1211（内線：56058）